Control activo del pico de pájaro

Nuevo control activo del pico de pájaro

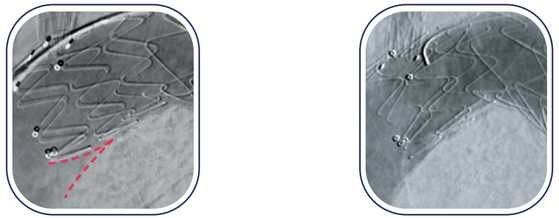

Antes

Después

Angiografía antes y después de usar el control del pico de pájaro

Proceso de resolución del pico de pájaro

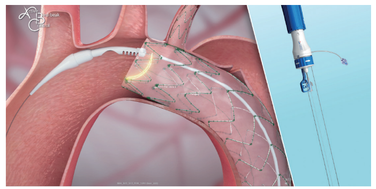

Después del despliegue de la prótesis, identifique la presencia de pico de pájaro

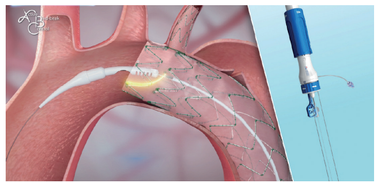

Retraiga suavemente el sistema de liberación hasta alcanzar la posición deseada

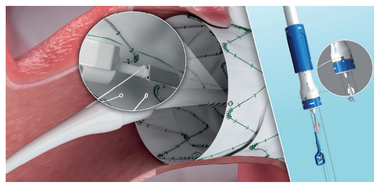

Accione el controlador 3 para desconectar los cables de control ABC

Especificaciones de producto

Especificaciones del modelo

CP	D1	D2	D3	–	L1	L2	L3

- Longitud extendida desde el extremo proximal del cuerpo principal hasta la rama
- Longitud de la rama
- Longitud del cuerpo principal
- Diámetro Distal de la rama
- Diámetro Distal del cuerpo principal
- Diámetro Proximal del cuerpo principal
- Cratos™

Ejemplo: CP322610-2003010

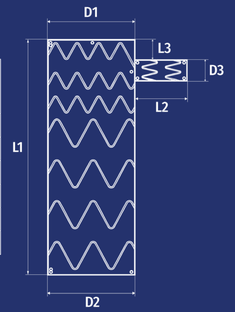

Especificaciones del Producto

Especificaciones del modelo	Rango de tamaño (mm)
Diámetro proximal del cuerpo principal (D1)	26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44
Diámetro distal del cuerpo principal (D2)	20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44
Posibilidades de conicidad	0 / 2 / 4 / 6 / 8
Diámetro distal de la rama (D3)	6 / 8 / 10 / 12 / 14
Longitud del cuerpo principal (L1)	100 / 120 / 150 / 170 / 180 / 200 / 210
Longitud de la rama (L2)	25 / 30
Longitud extendida desde el extremo proximal del cuerpo principal hasta la rama (L3)	05* / 10 / 15 / 20 / 25 / 30
Perfil de la vaina exterior (F)	22 / 24

* La longitud exacta del código 05 es de 7 mm, todos los demás códigos representan la longitud exacta

Cratos™ es un dispositivo fabricado a medida para el tratamiento de pacientes específicos. Como tal, no cuenta con el marcado CE y solo se puede suministrar a un paciente designado.

MicroPort Endovastec

Lombard Medical Limited, Lombard Medical House, 4 Trident Park, Didcot, OX11 7HJ
Tel: +44 (0)1235 750800 Email: globalinfo@endovastec-lm.com Website: www.lombardmedical.com

Todas las marcas comerciales citadas son propiedad de sus respectivos propietarios en sus respectivos países. Estos dispositivos solo deben ser utilizados por un médico autorizado. Indicaciones, contraindicaciones, las advertencias, los posibles eventos adversos y las indicaciones de uso se pueden encontrar en las instrucciones de uso y en el etiquetado del producto suministrado con cada dispositivo. La promoción, distribución o venta de estos dispositivos está prohibida en los países en los que no se hayan obtenido los certificados de registro o cualquier otra licencia. Este folleto es para el uso de las personas a las que se ha proporcionado y no debe distribuirse ampliamente como publicidad. Cualquier información puede ser modificada sin previo aviso. Cratos™ es fabricado por MicroPort Endovastec y distribuido en Europa por Lombard Medical Limited. No disponible para la venta en los Estados Unidos.
©2026 Lombard Medical Limited. Todos los derechos reservados. D01464_ES C

MicroPort™ Endovastec

Cratos™

Sistema de endoprótesis ramificada torácica

Trata el Arco, Preserva la Rama

Cratos™ es un dispositivo fabricado a medida para el tratamiento de pacientes específicos. Como tal, no cuenta con el marcado CE y solo se puede suministrar a un paciente designado

Plataforma validada



Diseño único de una sola pieza
Proporciona sellado anatómico
Reduce el riesgo de endofugas de tipo III y migración



Ángulos multidimensionales
Permite orientar la rama según los distintos requisitos anatómicos de la LSA



Múltiples mini stents proximales
Mejora la conformabilidad al arco aórtico



Anillo de soporte en la raíz de la rama
Proporciona soporte y mejora la permeabilidad de la rama

Nuevo Sistema de liberación

Active Bird-beak Control

Permite ajustar la alineación proximal del dispositivo si es necesario

Puntal más corto

Perfil reducido
- 22F
- 24F

Vaina exterior más larga
Desenredado simplificado de la guía de la rama y del posicionamiento de la rama

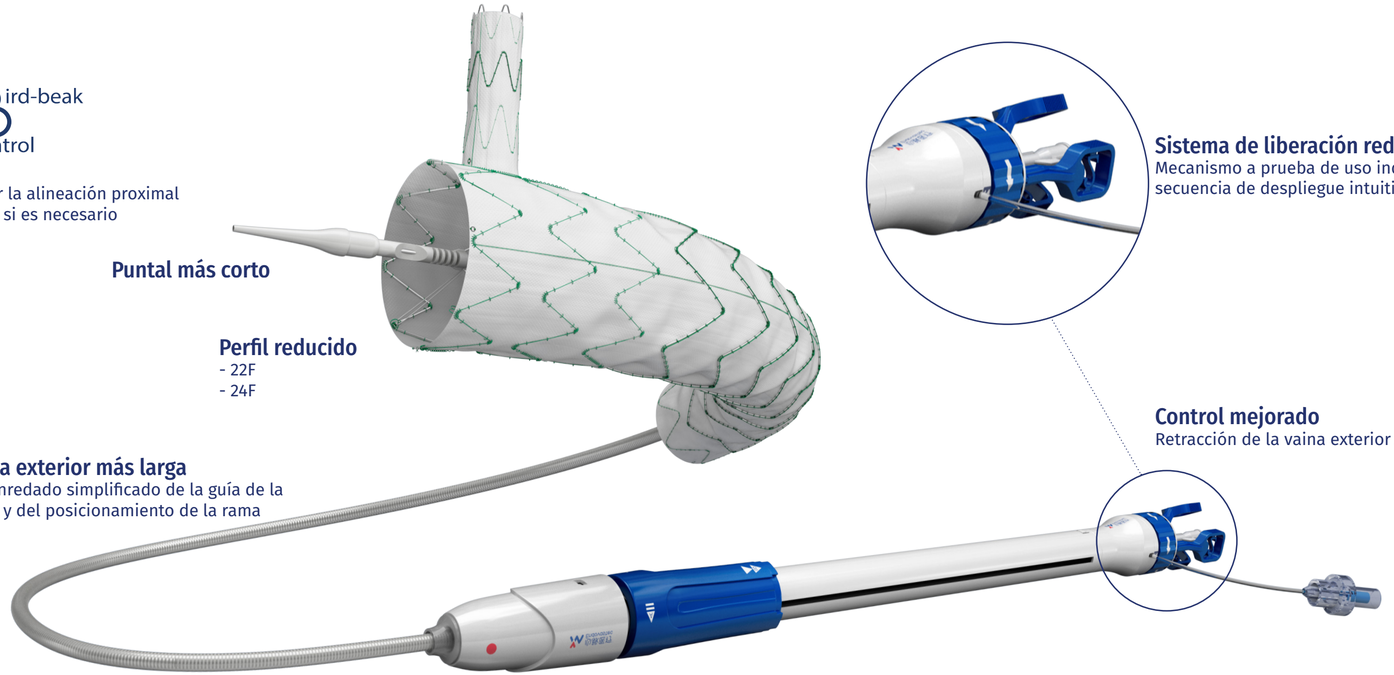

Sistema de liberación rediseñado
Mecanismo a prueba de uso indebido y secuencia de despliegue intuitiva

Control mejorado
Retracción de la vaina exterior simplificada

Opciones de rama

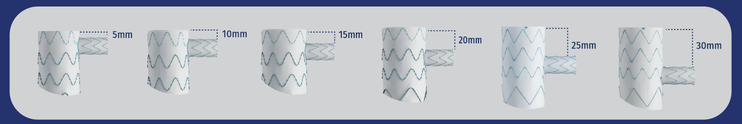

5 * - 30 mm de longitud extendida desde el extremo proximal del cuerpo principal hasta la rama
La longitud exacta de 5 mm es de 7 mm

Una solución segura y eficaz**

Permeabilidad de la rama **95.1%**

Incidencia de endofuga tipo I **2.2%**

Ausencia de mortalidad relacionada con la disección aórtica **98.9%**

Tasa de reintervención **0%**

** Fuente de datos: Resultados de seguimiento de 12 meses del ensayo clínico previo a la comercialización de Cratos